

質問回答書

質問事項について、次のとおり回答します。

(事業名)8－12児童館自動体外式除細動器(AED)賃貸借

NO.	質問事項	回 答
1	弊社の応札予定品は株式会社 CU製 IPAD シーユー SPR SPR-SPCL(RMS-Link付き)です。カタログ(黄色マーク入り)を添付いたします。仕様を満たしているとお認めいただけますか？	認めます。
2	仕様書5. 本体規格(8)につきまして：異常があった場合には発注者にメール等で連絡する機能を有していること。記載がございます。弊社もしくは提携会社の保守担当者のパソコン等から発注者へメールで連絡することはお認めいただけますか？メールを受信される機器は、パソコンですか？受信を予定されている発注者には各施設の担当者も含まれていますか？	認めます。なおメールの受信は、担当課パソコンのみを想定しています。
3	仕様書6. 付属品及び消耗品(3)救急セット：弊社の救急セットの内容物を添付いたします。仕様を満たしているとお認めいただけますか？	認めます。
4	遠隔管理システム(RMS)の設定、納品、保守管理、定期点検等は、提携会社等への第三者委託はお認めいただけますか？	認めます。

誰もが安心して使える、高性能なAEDはここにあります。

安心の最大8年保証

AEDの設置先情報の登録 有効期限内の適切な消耗品交換 を行っていた機器には

最大8年のメーカー保証 が付きます!



耐用期間8年間までメーカー保証!

※耐用期間を過ぎたAEDはご設置いただけません。古い機器は廃棄し、新しい機器と交換してください。
※上記イメージの交換時期は目安です。消耗品交換については有効期限前の早めの準備をお願いします。

見やすいインターフェイス



エラー状態表示

- ✕ 機器にエラーがあることを示しています。
- ⬜ バッテリー残量が不足していることを示しています。
- ⬜ 共通用電極パッドの使用済み、期限切れ、またはエラー状態を示しています。

一目で機器の状態を確認することができます。
1日に1回、自動で機器本体、電極パッドの有効期限、バッテリー残量を調べるセルフテスト機能が付いています。




小学生以上の傷病者には、小学生～大人用モード、およそ6歳未満には未就学児用モードを選択します。

※電極パッドを貼った後でも、電源を落とさことなくモード切替が可能です。
(あらかじめ傷病者の適切な対象モードを確認してください。)



選択したモードの傷病者の電極パッド貼付位置をイラストと光によってガイドします。

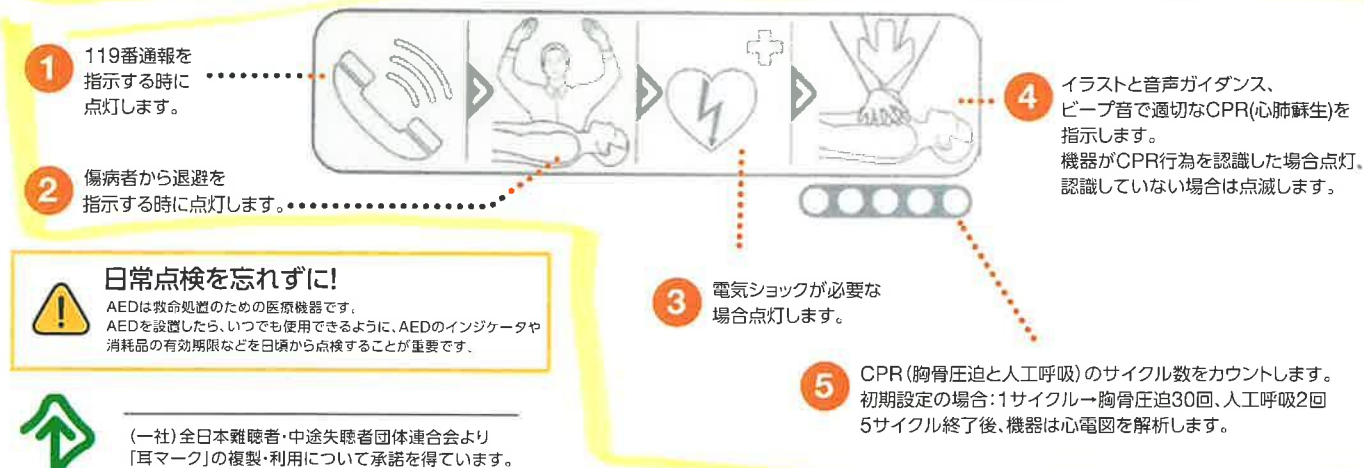


遠隔監視システム(RMS)


- 機器の状態をアイコン別に確認
- マップ上にAEDの設置場所や使用場所を表示
- AED状態や有効期限をグラフで表示



- 複数のAEDを一括管理
- 設置されたAEDごとに詳細情報を表示

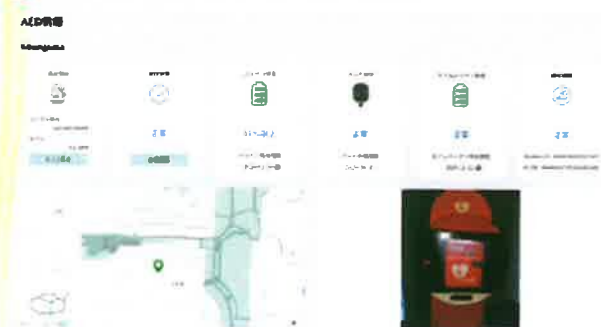

いつでもどこでもWEBやアプリで管理

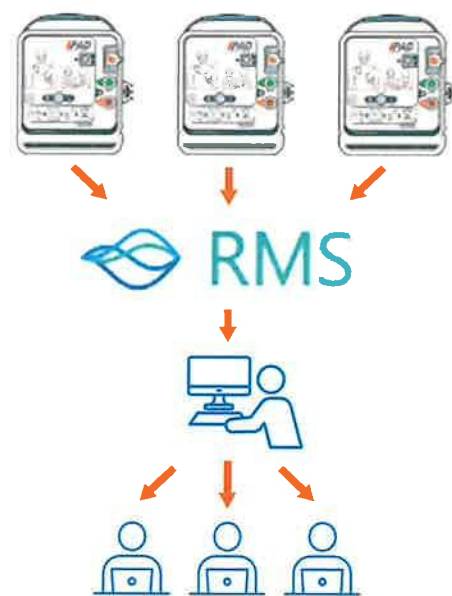

- セルフテスト結果の確認
- バッテリー残量確認
- 消耗品の有効期限管理
- AED耐用期間
- マップ上に位置情報を表示
- メールやSMS、アプリで通知 (AEDの異常時、使用時、消耗品交換時期)

※本サービスご利用の際は、事前にアカウント登録が必要です。詳しくは当社または、当社販売代理店までお問合せください。

オートボリューム機能

80dB 90dB



使用者に適切な音声ガイダンスが伝わるように、周りの騒音に合わせて自動で音量が上昇します。

高い防塵・防水性能



IP66 (IEC60529) を取得

防塵性能 IP6X 防水性能 IPX6

→ 粉塵が内部に入らない。 → あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない。



IPAD シーユー-SPR
医療機器承認番号:30300BZX00265000
一般の名称:非医療従事者向け自動除細動器
JRC蘇生ガイドライン2020準拠

あなたに寄り添う新世代AED

IPAD CU-SPR



標準構成品

SPR-SPCL
機器本体
(RMS-Link付)

SPR-01
キャリングケース
救急セット
(予備パッド同時収容可)

SPR-03
バッテリーパック
(使い捨て)

SPR-04
AED共通用電極パッド
(使い捨て)
販売名:除細動器用パッド1
製造販売届出番号:13B1X10153000012

オプション

- CPRマネキン
- 救急セット
- CU-SPRT (AED訓練器)
- 取扱DVD
- 救命データ転送用USBカード
- 各種キャビネットシリーズ
- 未就学児用パッド
販売名:除細動未就学児用パッド1
製造販売届出番号:13B1X10153000010

■ その他標準構成品

- 取扱説明書 (本体・RMS-Link)
- 保証書
- 添付文書 (本体・共通用電極パッド)
- JRC蘇生ガイドライン2020について
- AED設置情報に関する登録について
- 財団法人AEDマップ登録書
- IPADシーユー-SPR日常点検ラベル
- 設置シール
- IPADシーユー-SPR簡便使用ガイド

仕様			
販売名	IPADシーユー-SPR 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器	寸法	230×270×70 (W×L×H, mm) (AED本体:230×240×70)
電極パッド	共通用電極パッド (小学生～大人/未就学児) (一回限りの使い捨て)	質量	2.6kg (バッテリーパック、RMS-Link、電極パッドを含む) 2.0kg (RMS-Linkを除く)
出力 エネルギー	小学生～大人用モード:150J 未就学児用モード:50J	メモリ機能	5件のデータ保存が可能 (1件3時間まで、最長15時間のイベント情報・ECG情報) PC転送 (USBメモリ)
波形	二相性波形 (e-cube Biphasic) 傷病者の胸部インピーダンスの負荷に応じて自動調整	ガイド機能	インジケータ/イラスト表示、心肺蘇生コーチング機能/ 心肺蘇生行為の有無表示
バッテリー・ 容量	DC12V 4.2Ah 使い切りバッテリーパック 設置から最大5年 (設置環境、使用回数により異なる) 電気ショック200回以上 (新品の場合)	モード機能	小学生～大人用 / 未就学児用モード (ボタンで切り替え)
セルフテスト	バッテリー装着時、毎日、毎週、4週毎 (AED本体、バッテリーパック、電極パッド)	ステータス インジケータ	1つのステータスインジケータで3つの状態が確認可能 (電極パッドの期限および状態、バッテリー残量、機器のエラー有無)
RMS-Link バッテリー	リチウム電池CR123A 交換目安:約2年 (パナソニック製リチウム電池使用時)	ステータス ランプ	3色 (緑、黄、赤) のランプで機器の状態、消耗品期限が確認可能
RMS-Link 基本契約期間	通常5年 (オプションで最大8年まで利用可能)	防塵防水 性能	IP66 (IEC 60529 : 2013)
耐用期間	8年	保管環境	温度:0℃～50℃ 湿度:5%～95%
保証期間	通常5年 (最大8年保証プラン有)	輸送条件	輸送条件 (機器のみ、電極パッドとバッテリーパックは含まない) 温度:-20℃～60℃ 湿度:5%～95% (結露しないこと)
充電時間	・新しいバッテリーパックで「電気ショックが必要です」という 音声ガイダンスが出てから3秒以内 ・心電図解析の開始からの時間:新しいバッテリーパックで10秒 ・2回目以降の時間:CPR (心肺蘇生) ガイダンスの終了から 6秒以内	放電	機器は次のいずれかの場合に本体の内部にエネルギーを放電します。 ・電気ショックの実施前に傷病者の心電図が電気ショックを必要と しない心電図に変った場合 ・充電の完了後、30秒以内に電気ショックボタンを押さない場合 ・電源ボタンを1秒以上押して、機器をオフにした場合 ・傷病者から電極パッドを取り外した場合、 または電極パッドコネクタを機器から取り外した場合 ・傷病者のインピーダンスが電気ショックの適用範囲 (25Ω～175Ω) 外の場合
衝撃	いかなる縁、角、面も0.75 mの落下に対して耐える	振動	操作時:MIL-STD-810G Fig.514.6E-1, randomを満たす スタンバイ時:MIL-STD-810G Fig.514.6E-2, swept sine (helicopter) を満たす

※取扱説明書及び添付文書をよくお読みの上正しくお使いください。

※仕様、外觀などの一部が都合により変更されることがあります。予めご了承ください。

※AEDの設置の際は、AED設置者を置いて製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に保
持してください。特に、電極パッド/バッテリーの有効期限の経過及び定期的な交換を確実に実施してください。

※AEDの設置管理者は、AEDに不具合の事態が発生した時など及び点検時 (点検管理記録簿記載) 販売元の許可業者 (販
販) へ連絡し、購入した販売店にご連絡ください。また、製造販売元又は販売元からの情報提供方法等 (交換時
期のお知らせ等) については別途ご連絡してください。

※共通用電極パッドを未就学児に使用する場合、特に2枚のパッドが貼れ合うことがないように注意して
ください。

※電極パッドは再使用禁止であり、1回限りの使い捨てです。

※AEDの使用及び保管については添付文書の「使用保管条件」をご確認ください。

製造元 **CU Medical Systems, Inc.**
www.cu911.com

製造販売業者 **株式会社 CU**

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-10 虎ノ門桜田通ビル8F
TEL. 03-6205-7385 FAX. 03-6205-7386
AEDに関するご相談は ☎ aed-sales@cu911.com

コールセンター ☎ 0120-910-256

お問い合わせ先

株式会社 CU

レスキューセット説明資料

ペーパータオル（不織布）2枚


手袋 1双

蘇生用マウスピース 1個
（一方向性弁付きマスク）

カミソリ 1個

取扱説明書 1枚

ハサミ 1本

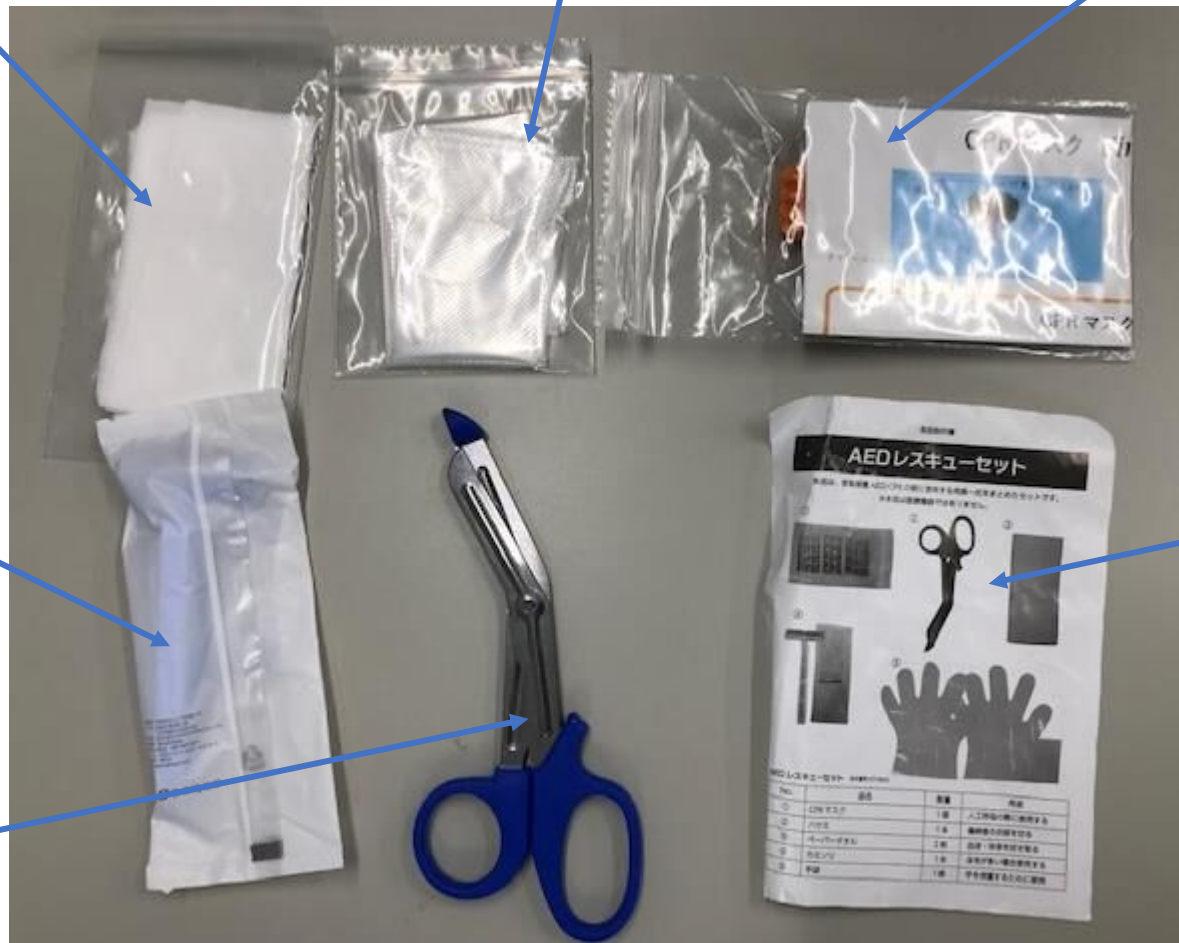

レスキューセット
【品番：RES-C S 9 9】