
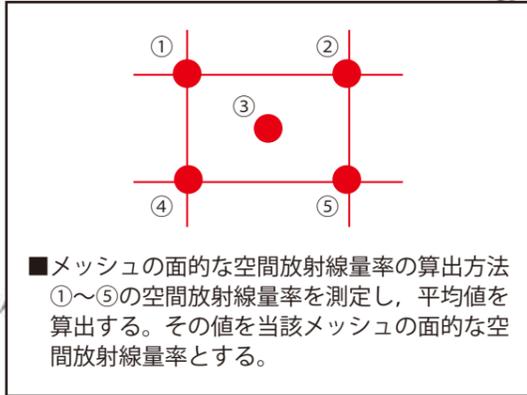


第7回汚染状況調査

調査日：H30.1.29-H30.2.23

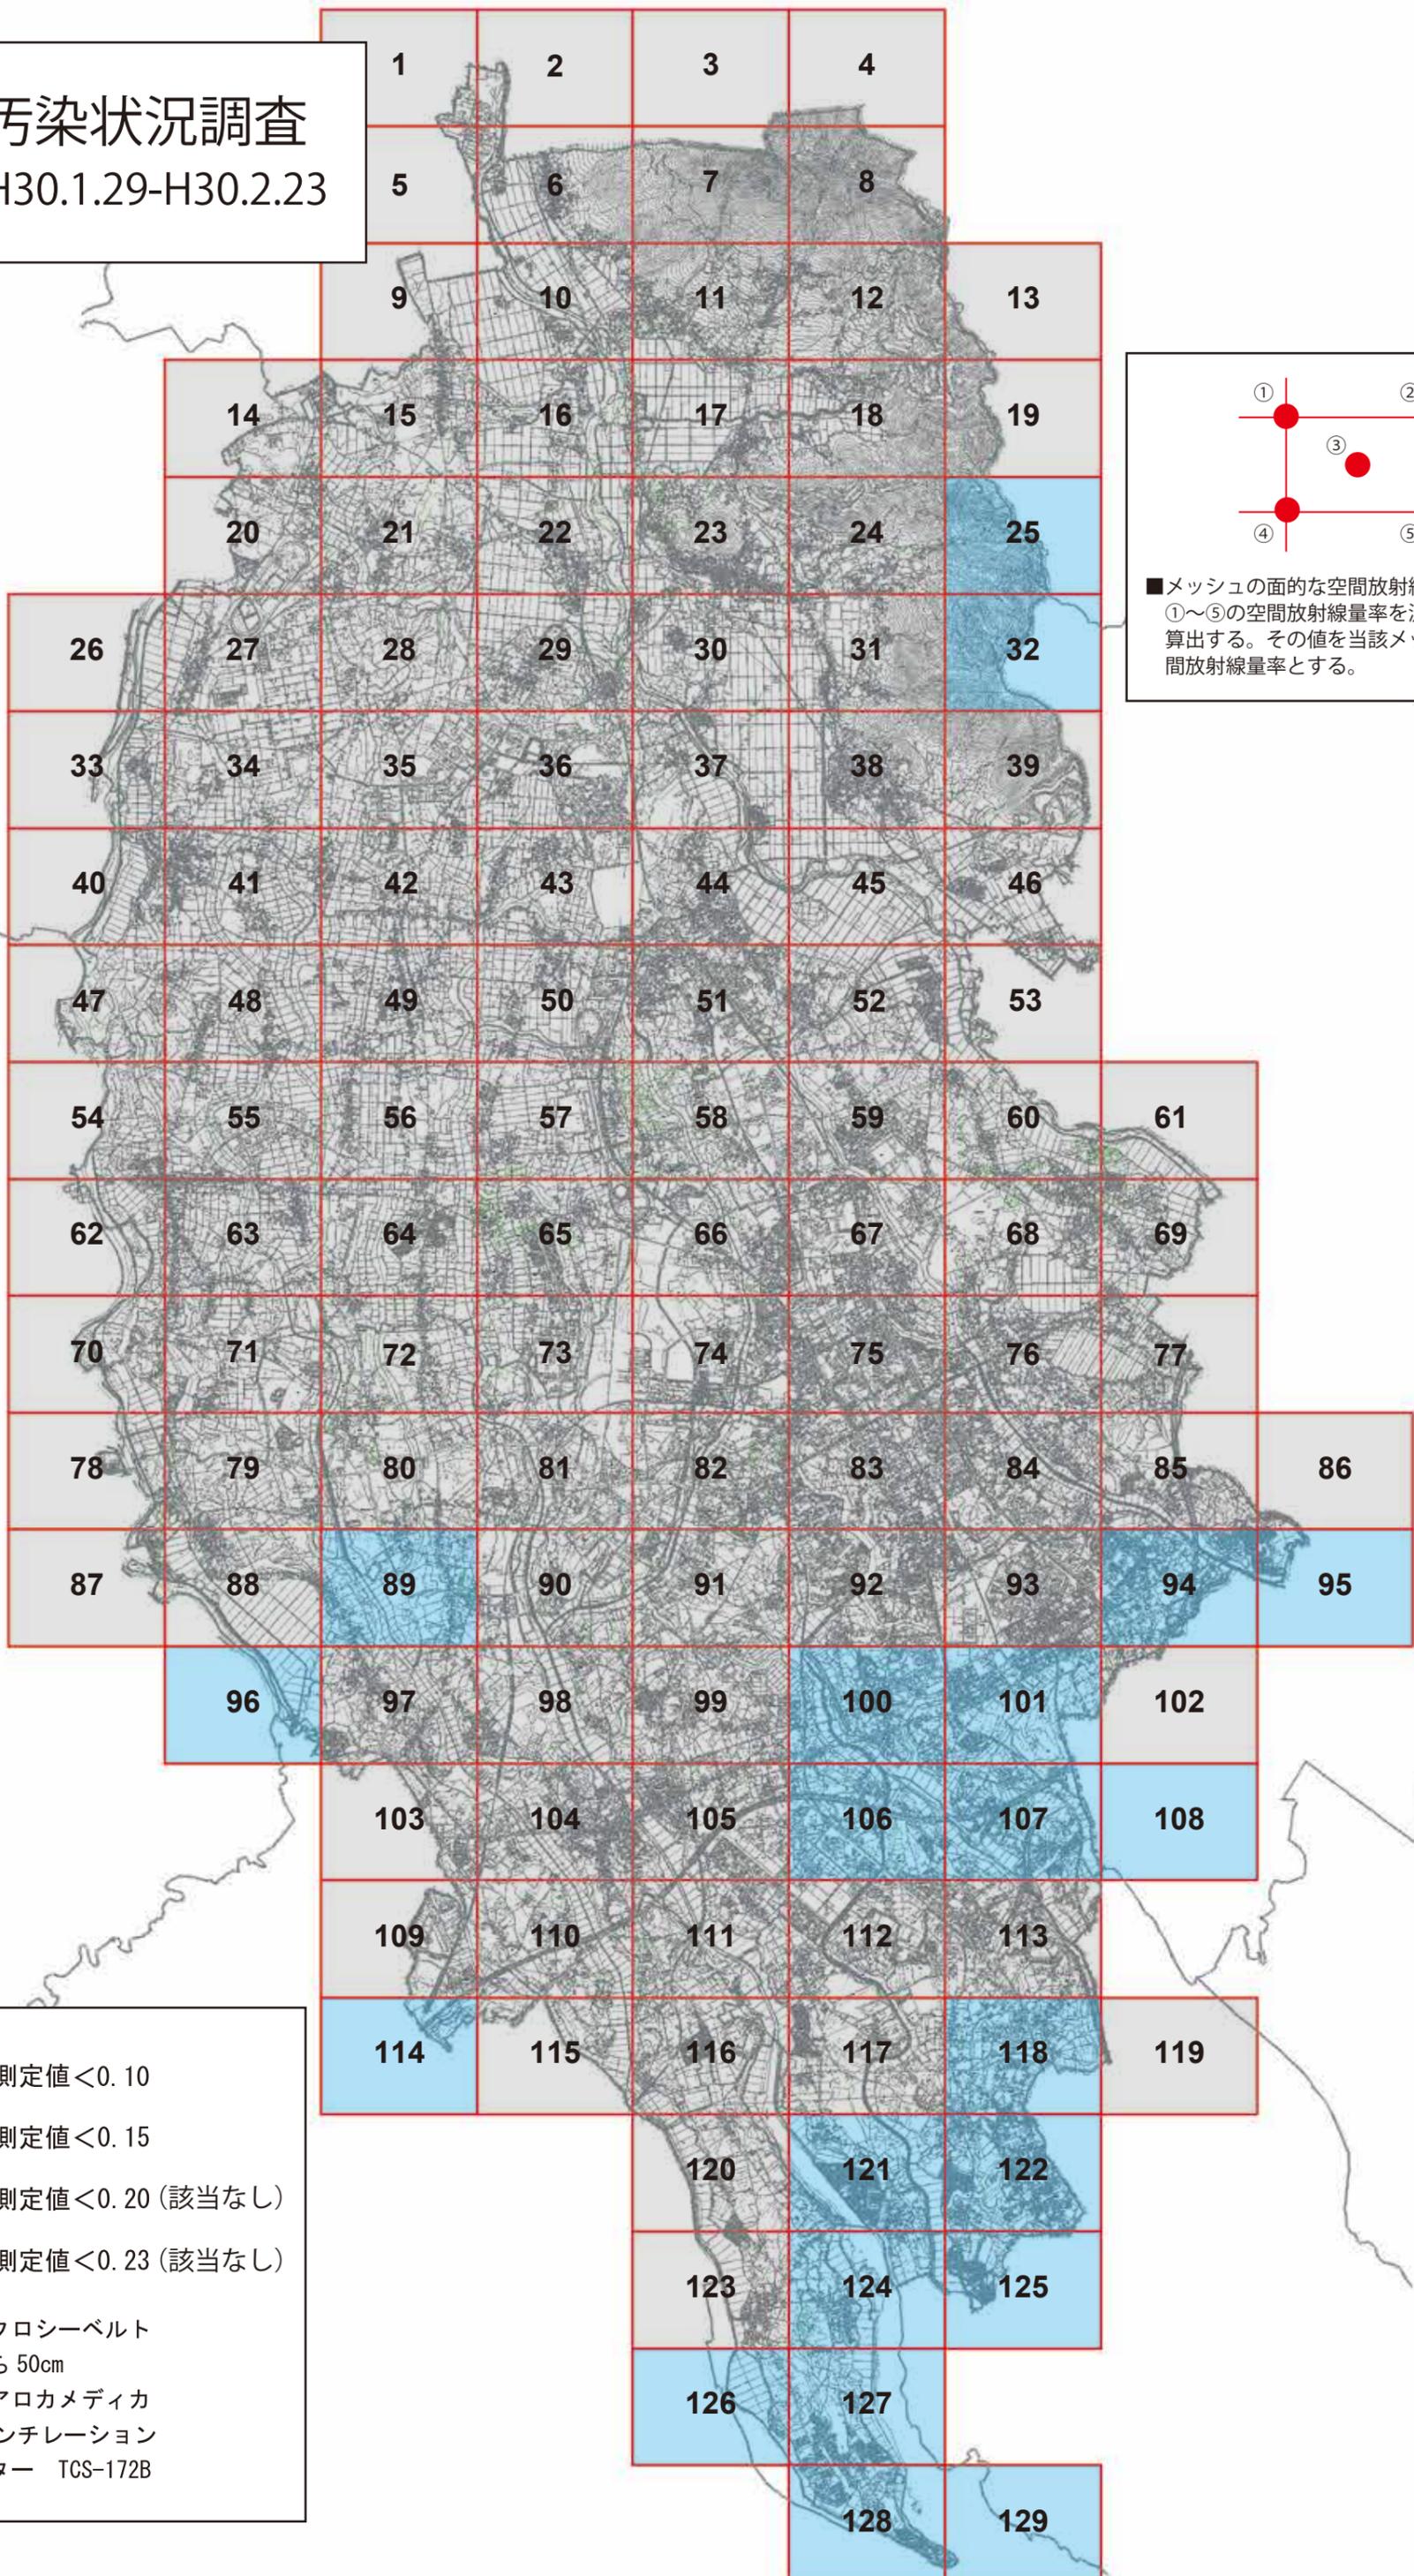

	測定値 < 0.10
	0.10 ≤ 測定値 < 0.15
	0.15 ≤ 測定値 < 0.20 (該当なし)
	0.20 ≤ 測定値 < 0.23 (該当なし)

単位：毎時マイクロシーベルト
測定高：地表から 50cm
測定機器：日立アロカメディカル社製 NaI シンチレーションサーベイメーター TGS-172B