


第6回汚染状況調査

調査日：H28.12.5-H29.1.6

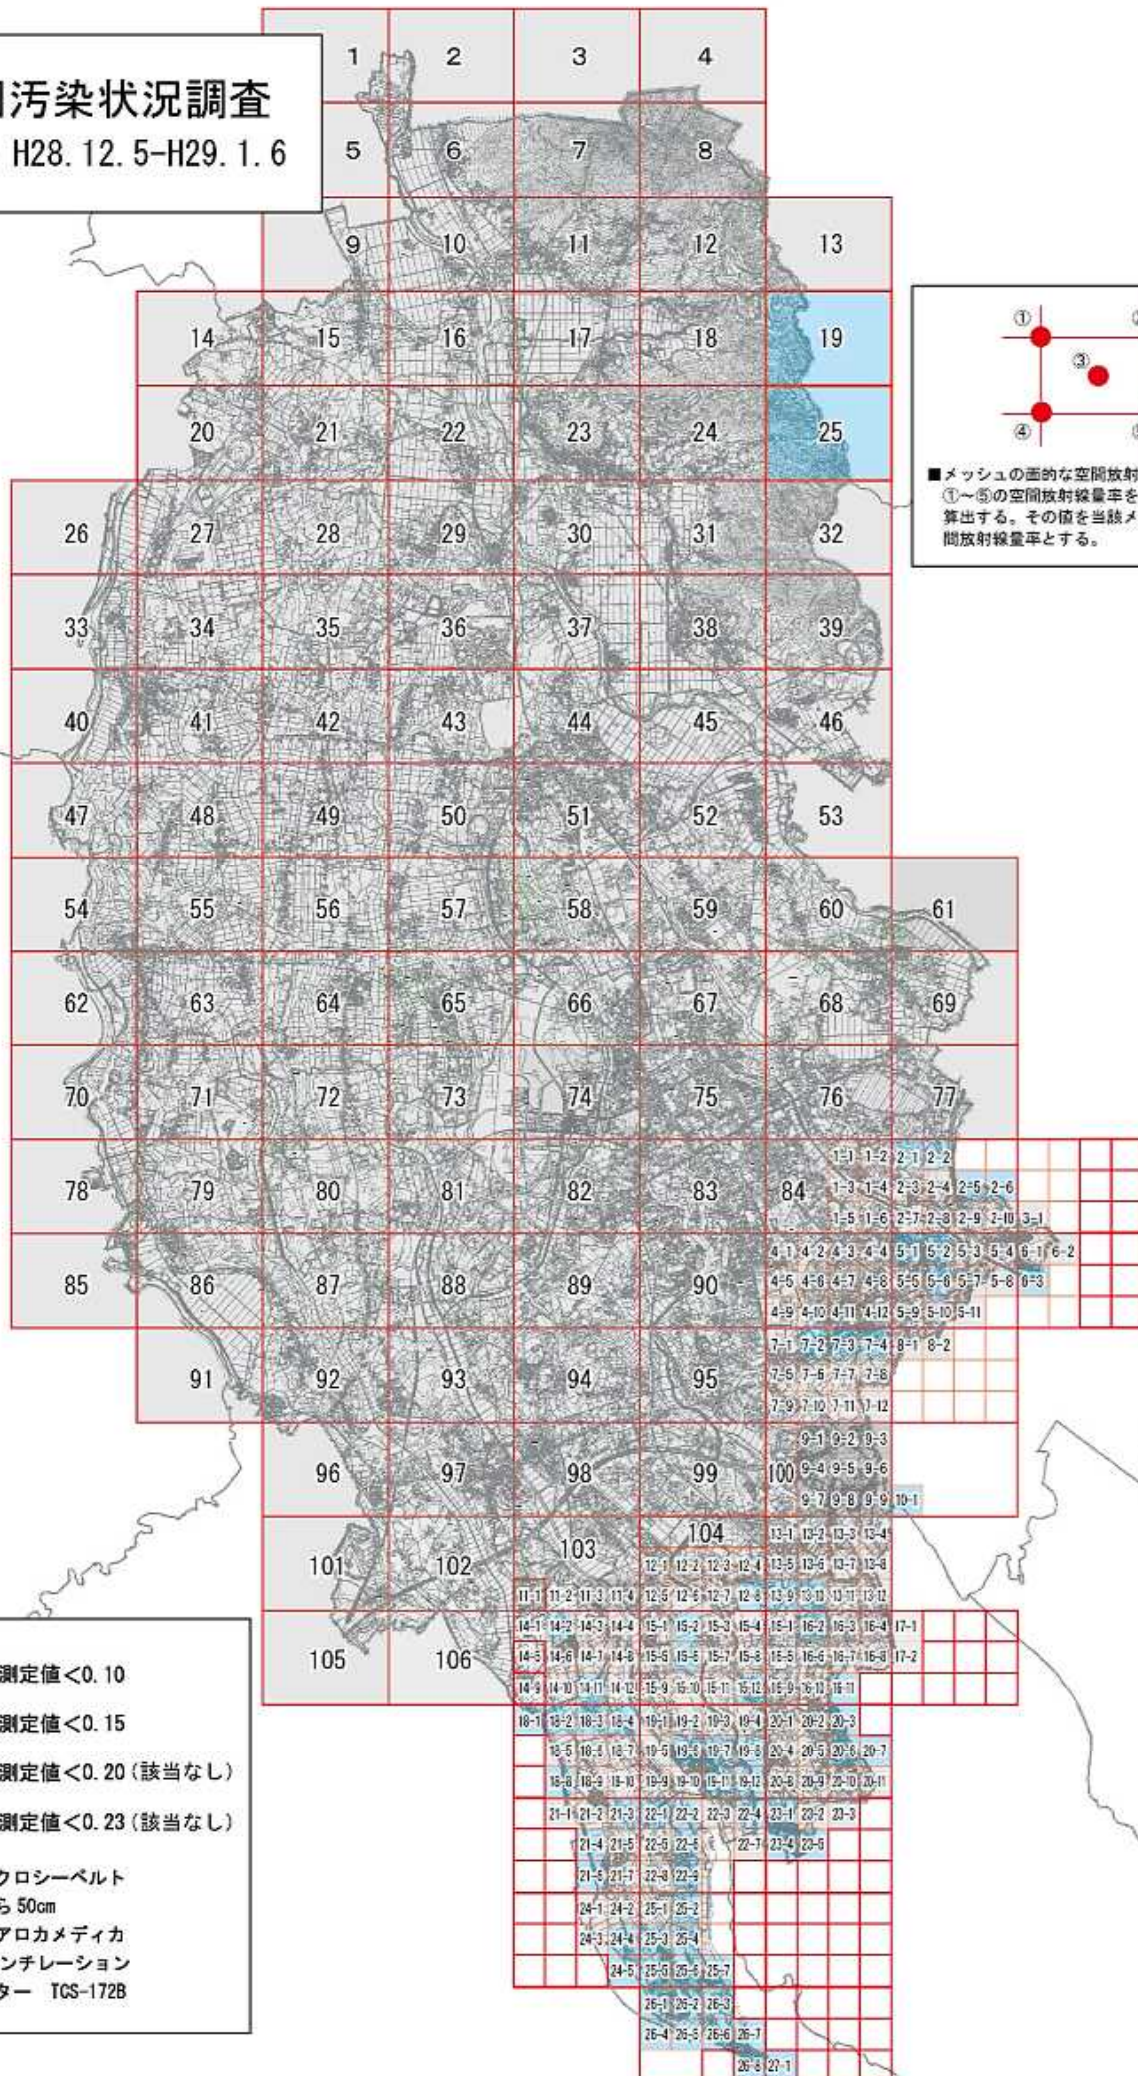

測定値<0.10

0.10≤測定値<0.15

0.15≤測定値<0.20(該当なし)

0.20≤測定値<0.23(該当なし)

単位：毎時マイクロシーベルト

測定高：地表から50cm

測定機器：日立アロカメディカル社製 NaIシンチレーション

サーベイメーター TCS-172B