


第2回汚染状況調査

調査日：H24.12.8-H25.1.18

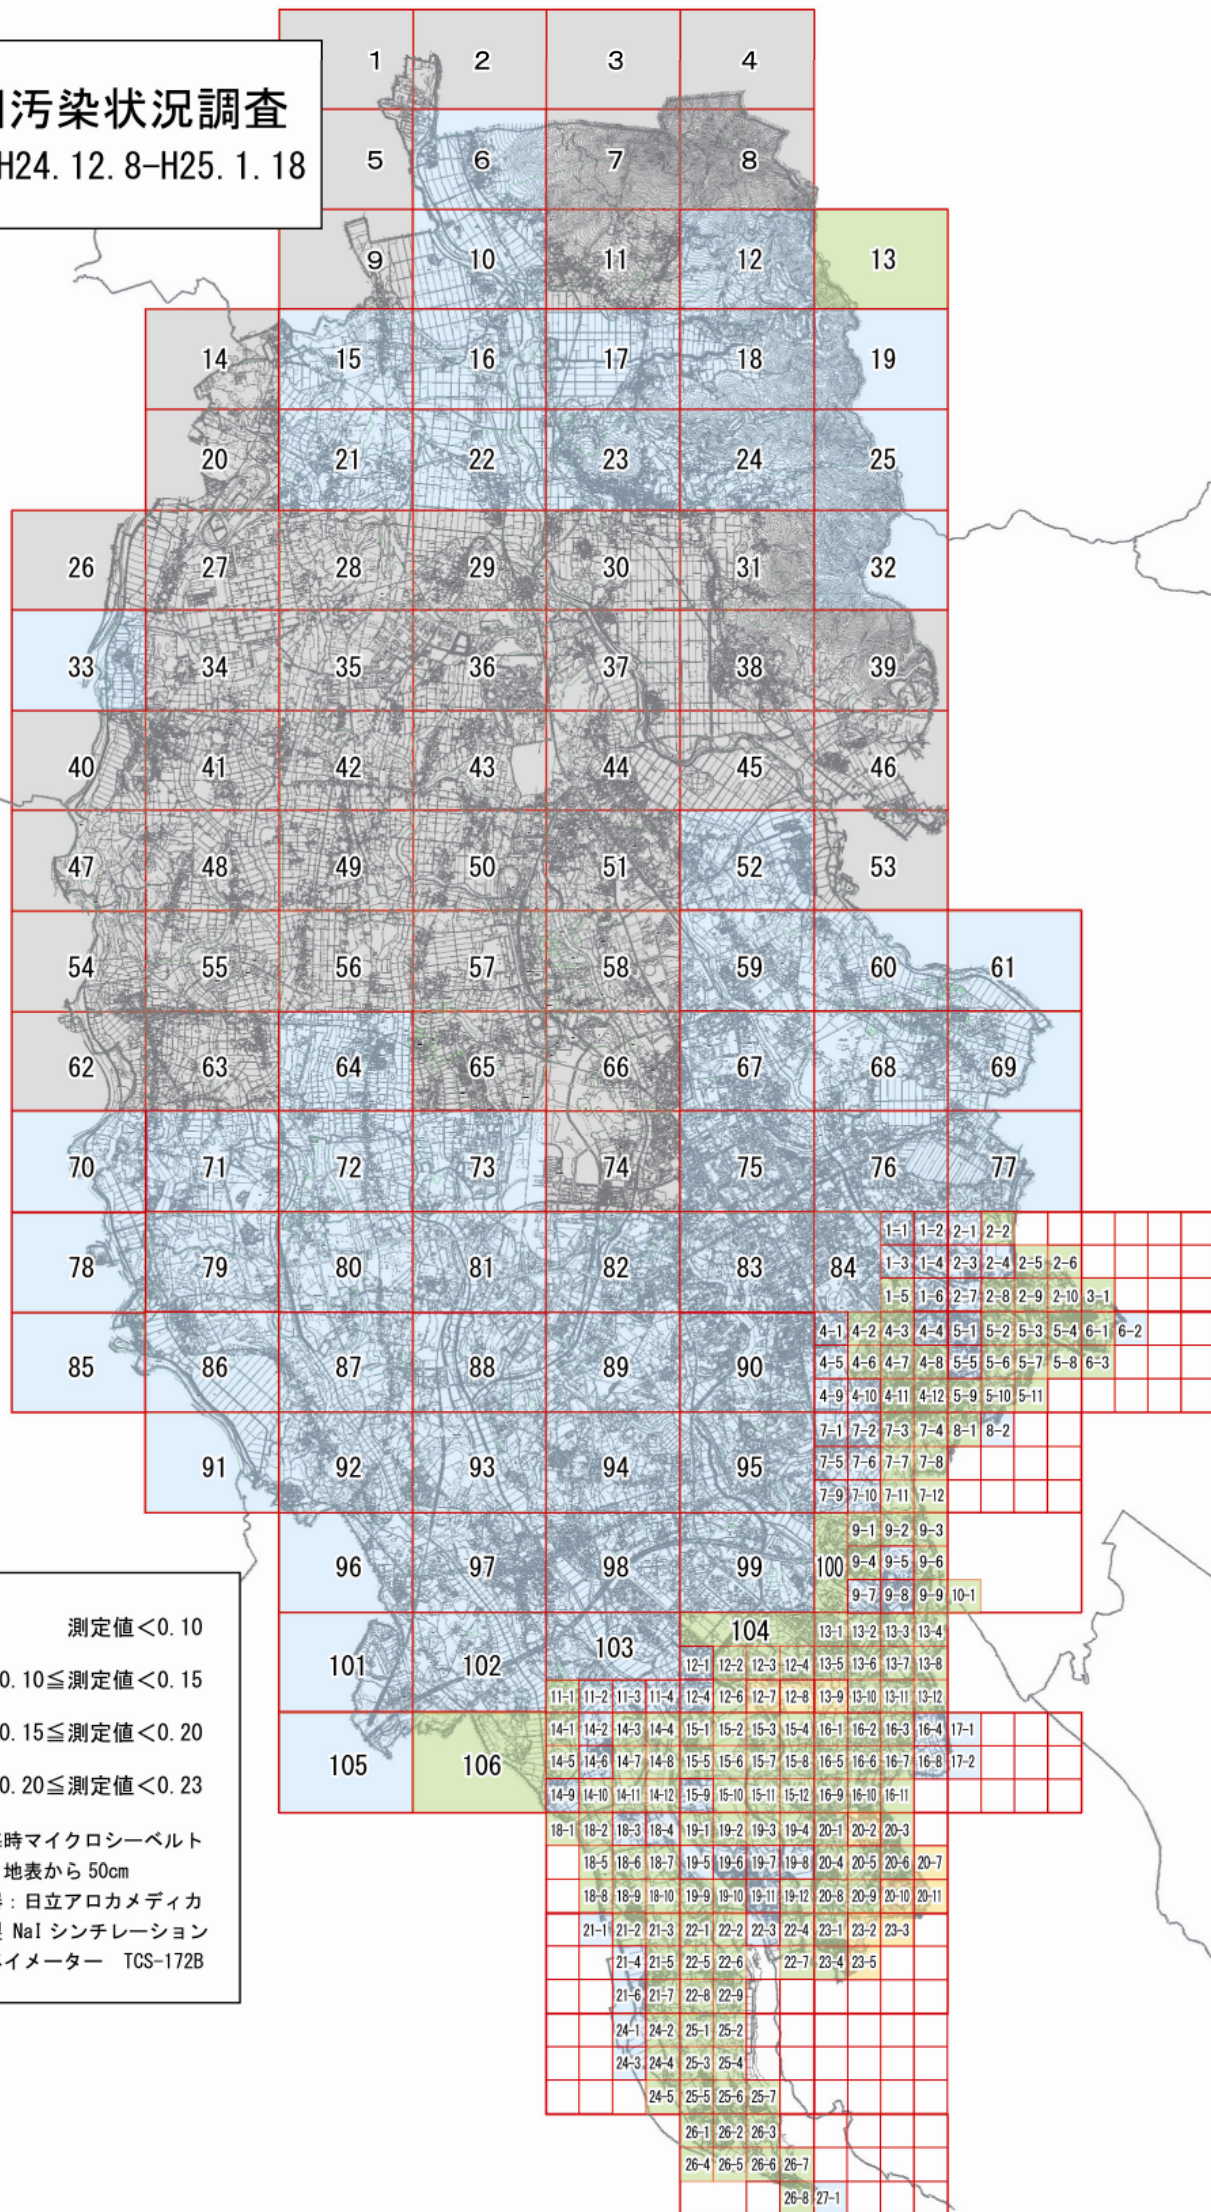

測定値 < 0.10
0.10 ≤ 測定値 < 0.15
0.15 ≤ 測定値 < 0.20
0.20 ≤ 測定値 < 0.23

単位：毎時マイクロシーベルト
測定高：地表から50cm
測定機器：日立アロカメディカル社製 NaI シンチレーションサーベイメーター TCS-172B