


放射性物質汚染対処特措法に
基づく汚染状況調査結果
調査日：H23.12.26～H24.2.10

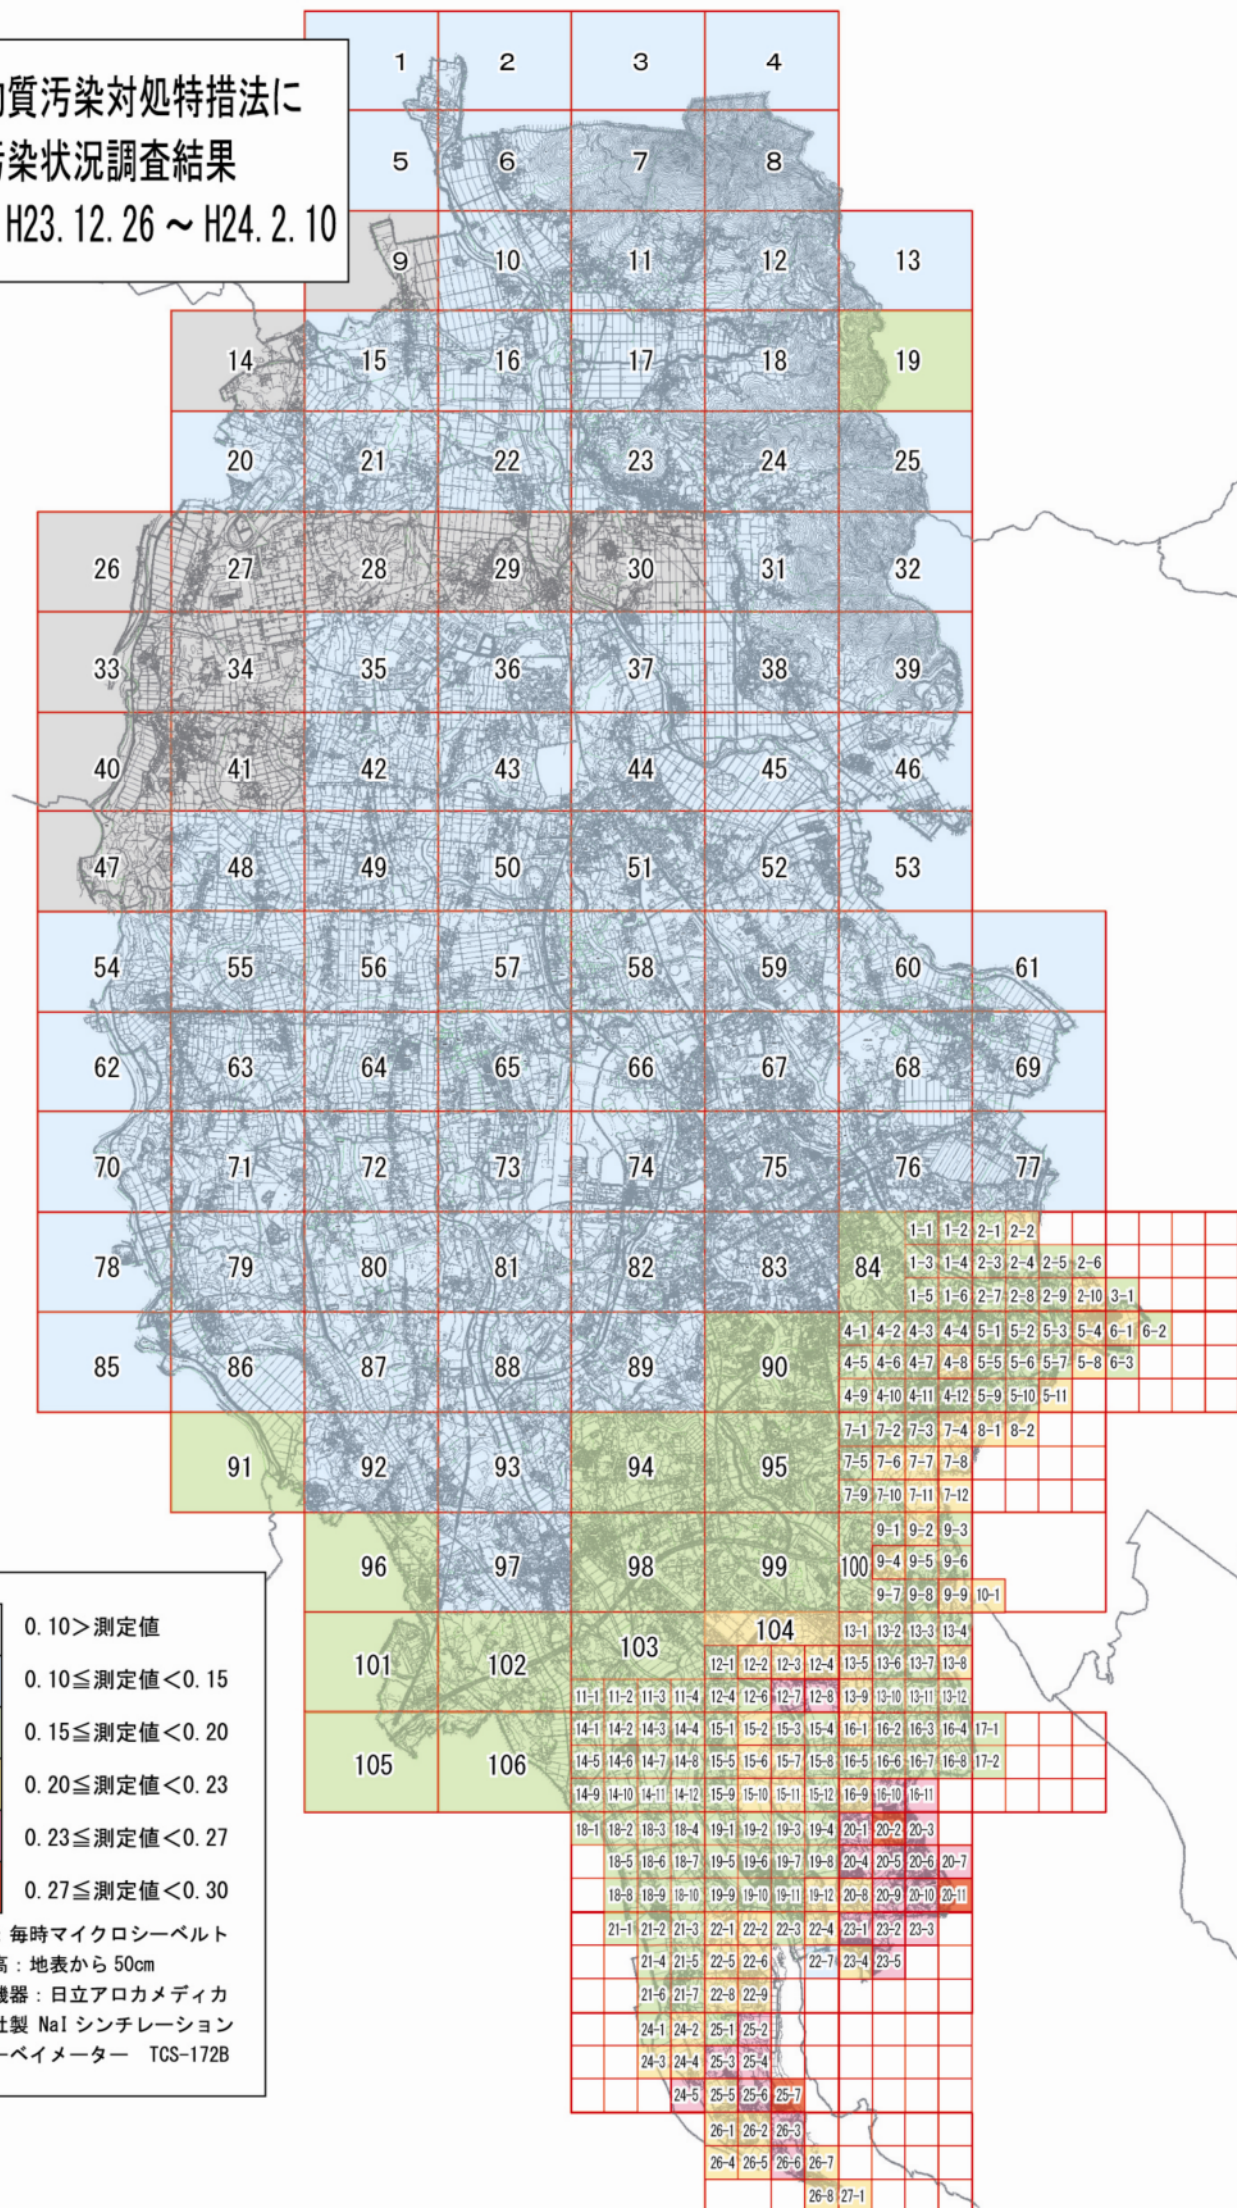

0.10 > 測定値

0.10 ≤ 測定値 < 0.15

0.15 ≤ 測定値 < 0.20

0.20 ≤ 測定値 < 0.23

0.23 ≤ 測定値 < 0.27

0.27 ≤ 測定値 < 0.30

単位：毎時マイクロシーベルト

測定高：地表から50cm

測定機器：日立アロカメディカル社製 NaI シンチレーションサーベイメーター TCS-172B